

Application Preventicus Heartbeats

Mode d'emploi



Table des matières

1	Symboles	5
2	Description du produit et objectif prévu	6
2.1	Objectif prévu.....	6
2.2	Utilisateurs visés	6
2.3	Indication, contre-indication et exclusions	7
2.4	Utilisation prévue	7
2.5	énéfice clinique	7
2.6	Principe de mesure : les bases de l'analyse de la courbe de pouls.....	7
3	Conseils	8
3.1	Mises en garde	8
3.2	Explications et informations complémentaires sur les performances et les risques résiduels	8
4	Durée de vie du produit.....	9
5	Sauvegarde de données	9
6	Première utilisation.....	9
6.1	Lancer l'application Preventicus Heartbeats	10
6.2	Lire et accepter la déclaration d'intention, y compris les avertissements, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.....	11
6.3	Saisir le code d'accès	11
6.4	S'inscrire et créer un compte utilisateur.....	12
7	Écran initial	12
8	Prise de mesure.....	13
8.1	Sélection de la variante de mesure	13
8.2	Préparation de l'appareil	14
8.3	Position de mesure correcte	15
8.4	Position de mesure alternative	16
8.5	Utiliser l'aide au positionnement.....	16
8.6	Reconnaître une bonne qualité de signal	17
8.7	Comportement pendant la mesure	17
8.8	Commencer la mesure	18
9	Création d'un rapport de mesure.....	18
10	Interprétation des résultats	19

10.1	Mauvaise qualité du signal.....	20
11	Rapports et Telecare	20
11.1	Aperçu du rapport de mesure.....	20
11.2	Liste des rapports de mesure.....	23
11.3	Telecare - Liste de rapports	24
11.4	Telecare - Commander un rapport.....	25
11.5	Telecare - Afficher l'état et le rapport	27
11.6	Accueil - Dernière mesure	27
12	Menu	28
12.1	Données de base.....	28
12.2	Fonction de rappel.....	29
12.3	Connexion.....	29
12.3.1	Compte d'utilisateur	30
12.3.2	Changement d'appareil.....	31
12.3.3	Utilisateurs multiples - changement d'utilisateur	32
12.4	À propos de Heartbeats	32
12.5	Choses à savoir.....	33
13	Version complète.....	33
13.1	Options d'achat	33
14	Supprimer le compte utilisateur.....	34
15	Santé.....	35
16	Boîte postale.....	35
17	Messages d'erreur.....	36
18	Désinstaller l'application	36
19	Données techniques.....	37
20	À propos du fabricant.....	37

Le présent mode d'emploi décrit l'utilisation et les fonctions de l'application Preventicus Heartbeats sur les appareils de type smartphone dotés d'un système d'exploitation iOS ou Android. Par souci de clarté, nous ne faisons référence qu'aux smartphones dans la suite du document.



Nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appli Preventicus Heartbeats.

Vous trouverez toujours une version actualisée du mode d'emploi à l'adresse suivante :

<https://www.preventicus.com/manuals-preventicus-heartbeats-app/>

Vous trouverez d'autres informations sur le site Web du service d'assistance de Preventicus (<https://www.preventicus.org/heartbeats/support-faqs/>). En outre, vous pouvez obtenir gratuitement une copie papier du guide d'utilisation sur le site Web d'assistance.

1 Symboles

Vous pouvez trouver les symboles suivants dans le présent mode d'emploi (la couleur et la taille peuvent varier):

Symbole	Signification
	Ce logiciel autonome est un dispositif médical faisant partie de la classe de risque IIa, conformément à la règle 11 du règlement (UE) 2017/745.
	Mise en garde Une mise en garde est toujours d'une importance critique en termes de sécurité.
	Conseil Un conseil attire l'attention sur des informations très utiles.
	Indication du fabricant
	Consulter le mode d'emploi électronique.
	dispositif médical

2 Description du produit et objectif prévu

L'application Preventicus Heartbeats est un logiciel qui enregistre la courbe de pouls, utilise les données pour analyser le rythme cardiaque et fournit les résultats.

Les courbes de pouls sont enregistrées dans l'application à l'aide d'une caméra de smartphone par simple contact avec le bout du doigt. Une analyse du rythme cardiaque est ensuite effectuée à partir de la courbe de pouls enregistrée. Les résultats de l'analyse du rythme cardiaque sont fournis dans l'application Preventicus Heartbeats. Si des signes d'arythmie cardiaque sont détectés, s'ils ne sont pas sous contrôle médical et s'ils se répètent, une évaluation médicale plus poussée par un professionnel est recommandée.

Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez tout autre symptôme inquiétant, veuillez immédiatement consulter un médecin.

En fonction de l'évaluation, l'application Preventicus Heartbeats peut vous classer dans l'une des trois catégories suivantes : aucune anomalie, extrasystoles suspectes (>5 % de tous les battements sont irréguliers) et arythmie absolue avec suspicion de fibrillation auriculaire. De plus, des informations sont fournies sur les bradycardies et les tachycardies suspectes sans différencier leur cause.

Le rythme cardiaque est analysé à l'aide de courbes de pouls d'une minute et de cinq minutes. Les résultats de l'analyse du rythme cardiaque peuvent être fournis pour une et cinq minutes. L'intégralité des perturbations et des artefacts potentiels dans les données est détectée et éliminée. Afin d'améliorer la qualité du signal des données de mesure, il est possible de recourir à une méthode algorithmique, incluant des techniques d'intelligence artificielle, pour identifier et traiter, à partir du signal vidéo enregistré, les composantes du signal présentant une qualité suffisante pour permettre une analyse ultérieure.

Dans ses propres études cliniques, Preventicus a prouvé sa capacité à détecter la fibrillation auriculaire et les extrasystoles ainsi qu'à déterminer avec précision la fréquence cardiaque (voir également : <https://www.preventicus.org/evidence/>). Il a été démontré que l'algorithme sous-jacent de ce produit peut différencier la fibrillation auriculaire du rythme cardiaque normal avec une précision de plus de 96 %.

2.1 Objectif prévu

L'application Preventicus Heartbeats est utilisée pour détecter les arythmies cardiaques sous la forme d'un diagnostic suspecté ainsi que pour déterminer et caractériser le rythme cardiaque. Les arythmies cardiaques suivantes peuvent être détectées : arythmie absolue avec suspicion de fibrillation auriculaire, extrasystoles et battements cardiaques irréguliers, fréquence cardiaque avec signes de bradycardie et de tachycardie.

Le résultat obtenu n'est qu'une suspicion éventuelle (« diagnostic suspecté ») et non un diagnostic au sens médical du terme. Les résultats obtenus ne sont donnés qu'à titre d'information et ne remplacent en aucun cas un diagnostic, un conseil, des soins ou un traitement personnalisés auprès d'un professionnel de la santé ou d'un professionnel ayant reçu une formation médicale.

2.2 Utilisateurs visés

L'application Preventicus Heartbeats peut être utilisée de manière autonome par les personnes suivantes :

- Les personnes qui ont confiance dans l'utilisation des smartphones et des wearables
- Les personnes qui peuvent lire et comprendre des textes écrits en lettres latines et en chiffres arabes
- Les personnes ayant un bon niveau de langue dans les langues disponibles pour l'application (voir chapitre 18)

2.3 Indication, contre-indication et exclusions

L'application Preventicus Heartbeats est destinée aux indications suivantes :

- Personnes présentant une suspicion d'arythmie cardiaque telle que la fibrillation auriculaire.
- Personnes, quel que soit leur sexe
- Personnes âgées de 18 ans et plus
- Personnes n'ayant pas de déficience visuelle ou n'ayant qu'une déficience visuelle légèrement corrigée
- Tissu cutané sain avec lequel la caméra entre en contact.

Toutefois, l'application Preventicus Heartbeats n'est pas destinée à être utilisée par des personnes

- porteuses d'un stimulateur cardiaque, d'un DAI ou d'autres dispositifs électroniques implantés, car ceux-ci sont capables de contrôler le rythme cardiaque naturel
- souffrant de troubles cognitifs

2.4 Utilisation prévue

À l'aide de l'application Preventicus Heartbeats, les mesures doivent être prises à une température ambiante et dans des conditions de luminosité normales. L'appareil ne doit être utilisé que sur des tissus cutanés sains. Pendant la mesure, le doigt ne doit pas toucher le flash. Il est fortement déconseillé d'utiliser ce produit si vous avez une sensibilité réduite à la douleur. L'appli ne doit pas être utilisée lorsque l'appareil est en charge.

L'appli Preventicus Heartbeats est destinée à être utilisée sur un appareil testé et approuvé par Preventicus GmbH à cette fin. Une liste actualisée peut être consultée sur les liens suivants :

<https://heartbeats.preventicus.com/devices/fr>

2.5 bénéfice clinique

Les arythmies cardiaques, en particulier la fibrillation auriculaire non détectée, sont associées à une augmentation significative du risque d'accident vasculaire cérébral. Bien souvent, la fibrillation auriculaire n'est pas perceptible, n'apparaît fréquemment que de manière sporadique et est donc généralement difficile à diagnostiquer.

C'est pourquoi les associations de cardiologie recommandent une mesure indépendante et régulière du rythme cardiaque à l'aide d'applications, de technologies portables ou de montres connectées adaptées. Si la fibrillation auriculaire est détectée et confirmée ultérieurement par un médecin à l'aide d'un ECG, le risque d'AVC peut être réduit ou normalisé à l'aide de médicaments. L'appli Preventicus Heartbeats offre une solution de mesure indépendante et régulière du rythme cardiaque afin de détecter les signes précoces de fibrillation auriculaire, de conduire plus rapidement les personnes concernées vers un diagnostic et une thérapie ultérieure par un cardiologue et, par conséquent, de réduire le risque d'AVC.

2.6 Principe de mesure : les bases de l'analyse de la courbe de pouls.

Avec Preventicus Heartbeats, vous pouvez enregistrer votre courbe de pouls à l'aide du bout de votre doigt et de l'appareil photo de votre smartphone en plaçant votre doigt sur l'objectif de l'appareil photo et en projetant la lumière du flash sur le bout de votre doigt. La courbe du pouls peut être dérivée du signal de l'appareil photo à l'aide de méthodes d'analyse du signal. Cette méthode est comparable à la procédure médicale de la photopléthysmographie. La courbe du pouls correspond à la pulsation du sang causée par l'activité cardiaque.

Les signes potentiels d'arythmie cardiaque peuvent être détectés en utilisant la variabilité du rythme cardiaque en combinaison avec les méthodes d'analyse des biosignaux.

3 Conseils

3.1 Mises en garde



L'utilisation sûre de Preventicus Heartbeats n'est garantie que si les mises en garde sont respectées.

1. Retirez, le cas échéant, les housses de protection de votre smartphone.
2. N'effectuez pas la mesure lorsque l'appareil est branché au secteur.
3. Si le flash de votre smartphone devient sensiblement trop chaud en dépit d'une utilisation correcte (doigt sur la lentille de la caméra et non pas sur le flash), veuillez interrompre la mesure.
4. En cas de sensibilité réduite à la douleur, nous déconseillons l'utilisation de ce produit.
5. Les médicaments influençant la fréquence cardiaque, les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs peuvent fausser les résultats de l'analyse du rythme cardiaque.

i Conseil : nous vous invitons à nous signaler, ainsi qu'à l'autorité compétente du pays dans lequel vous résidez, tout incident grave survenu en association avec l'appli Preventicus Heartbeats. (Pour obtenir de plus amples informations sur les personnes à contacter, veuillez consulter la section Informations sur le fabricant).

Courriel : support@preventicus.com

3.2 Explications et informations complémentaires sur les performances et les risques résiduels

L'ECG est l'étalon-or du diagnostic du rythme cardiaque. Une analyse du rythme cardiaque à partir de l'onde de pouls est une méthode de dépistage appropriée pour une étape préliminaire avant d'autres procédures de diagnostic. L'application Preventicus Heartbeats est utilisée par le patient lui-même dans un environnement non clinique et n'est pas destinée à être utilisée pour la prise de décision dans des situations où le pronostic vital est engagé ni pour la surveillance en temps réel des fonctions vitales. Elle n'interfère pas non plus avec les voies de diagnostic ou les mesures thérapeutiques basées sur les directives existantes.

Il convient de faire une distinction fondamentale entre la détection (dépistage ou surveillance) de la fibrillation auriculaire (FA) et son diagnostic ultérieur. La FA doit être exclusivement diagnostiquée conformément aux directives avec un ECG de la paroi thoracique, généralement par des cardiologues. Les applications Preventicus ne sont pas destinées aux diagnostics définitifs de la FA avec des implications thérapeutiques, mais uniquement au dépistage ou à la surveillance de la FA sans implications thérapeutiques. Une implication thérapeutique ne peut être dérivée que d'un véritable ECG.

Selon les études réalisées, Preventicus Heartbeats détecte la fibrillation auriculaire avec une précision globale de 96 %. La sensibilité (taux de vrais positifs) est d'environ 92 %. La sensibilité indique la probabilité que la fibrillation auriculaire soit reconnue comme telle. En parallèle, la spécificité (taux de vrais négatifs) donne le pourcentage d'utilisateurs qui ne souffrent pas de fibrillation auriculaire et pour lesquels le résultat (feu vert) est correct. La spécificité de Preventicus Heartbeats est de 99 %.

La fibrillation auriculaire peut survenir de manière sporadique. Si elle n'est pas présente au moment de la mesure, elle ne peut pas être détectée par Preventicus Heartbeats.

Il est impossible d'exclure qu'une mauvaise qualité du signal, des maladies préexistantes (telles que le diabète, les maladies vasculaires ou une chirurgie cardiovasculaire antérieure), des médicaments affectant le pouls ou des stimulateurs cardiaques puissent fausser la précision de Preventicus Heartbeats.

4 Durée de vie du produit

On entend par durée de vie la période précédant la sortie d'une nouvelle version de l'application. Celle-ci est indiquée par une augmentation d'au moins le deuxième chiffre du numéro de version. Le numéro de version est spécifié dans les app stores respectifs.

<https://apps.apple.com/de/app/preventicus-heartbeats/id1122978949?l=en>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preventicus.heartbeats&hl=en_US

Les informations sur les mises à jour sont fournies par le système d'exploitation. En fonction des paramètres utilisateur correspondants sur le smartphone, la mise à jour est effectuée automatiquement ou doit être approuvée et lancée activement par vous.

5 Sauvegarde de données

Les données peuvent être sauvegardées de la manière suivante :

Vous pouvez exporter les rapports et les envoyer sous forme de PDF, par exemple par e-mail. Les rapports peuvent ensuite être sauvegardés dans d'autres bases de données (par exemple PDMS, logiciel Praxis) ou sur d'autres supports de stockage (par exemple disque dur, carte mémoire).

Preventicus GmbH recommande de protéger le smartphone sur lequel l'application est exécutée avec un code (PIN, numéro d'identification personnel), une reconnaissance faciale ou une reconnaissance d'empreinte digitale. Cette protection du smartphone est importante car des informations de santé personnelles y sont stockées.

6 Première utilisation

L'application Preventicus Heartbeats peut être exécutée sur les smartphones dotés des systèmes d'exploitation suivants : iOS 15 ou supérieur ou Android 8.0 et supérieur.

La liste actualisée des appareils testés et approuvés peut être consultée sur le site <https://heartbeats.preventicus.com/devices/fr>.

Pour les smartphones pour lesquels l'application n'est manifestement pas adaptée, l'application Preventicus Heartbeats n'apparaîtra pas dans la boutique correspondante.

Vous pouvez télécharger et installer l'application Preventicus Heartbeats à partir des liens suivants :

Lien vers l'App Store pour les appareils iOS :

<https://apps.apple.com/de/app/preventicus-heartbeats/id1122978949?l=en>

Lien vers le Play Store pour les appareils Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preventicus.heartbeats&hl=en_US

Après avoir installé l'application Preventicus Heartbeats et lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous devez d'abord lire et accepter la déclaration d'intention, y compris les avertissements, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité pour pouvoir continuer. Si vous disposez d'un code d'accès, vous aurez alors la possibilité de le saisir. Vous pouvez également sauter cette étape. Dans les deux cas, vous accéderez à l'écran d'enregistrement pour créer un compte pour l'application.

Conditions générales d'utilisation

<https://www.preventicus.org/terms-and-conditions/>

Politique de confidentialité de l'application Preventicus Heartbeats

<https://www.preventicus.org/heartbeats/privacy-policy-of-using-the-app/>

6.1 Lancer l'application Preventicus Heartbeats

Après avoir installé l'application, le cœur Preventicus Heartbeats apparaît sur l'écran de votre smartphone. Lorsque vous cliquez sur le cœur, l'application s'ouvre.

Lorsque l'application est ouverte, le premier écran que vous voyez est l'écran d'accueil. L'écran affiche des icônes relatives au produit, y compris une icône pour le mode d'emploi. En cliquant sur l'icône, vous ouvrez le mode d'emploi dans une fenêtre de navigation supplémentaire sur votre smartphone.

L'écran de démarrage se compose de cinq pages au total contenant des informations sur les fonctions importantes de l'application et, en outre, sur le programme de soins préventifs en coopération avec les compagnies d'assurance maladie. Vous pouvez consulter les pages individuellement en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite.

Si vous utilisez l'application Preventicus Heartbeats pour la première fois, veuillez cliquer sur le bouton "Nouveau ici" pour continuer.

Si vous êtes déjà un utilisateur actif de l'application, passez au chapitre 12.3 Connexion.



6.2 Lire et accepter la déclaration d'intention, y compris les avertissements, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Avant de commencer à utiliser Preventicus Heartbeats, il est important de savoir comment il fonctionne et à quoi vous devez faire attention. Par conséquent, dans l'étape suivante, veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation, les déclarations d'objectif et d'avertissement, ainsi que les informations relatives à la protection de la vie privée. Pour continuer, vous devez d'abord accepter ces conditions. Pour ce faire, cliquez sur les cases rectangulaires pour cocher la case indiquant que vous les acceptez. Cliquez ensuite sur le bouton "Continuer" pour poursuivre.

Les deux premières cases à cocher concernant les conditions d'utilisation, la finalité, y compris les avertissements, et les informations relatives à la protection de la vie privée sont des champs obligatoires et doivent être acceptées pour continuer. La troisième case à cocher est facultative et ne doit donc pas être acceptée pour continuer.

14:56

< Retour

Nous avons besoin de votre accord

Pour pouvoir utiliser Preventicus Heartbeats, vous devez savoir comment fonctionne Preventicus et accepter ce qui suit.

- ☐ J'accepte les conditions d'utilisation et j'ai lu les avertissements ainsi que les informations relatives aux utilisations prévues.
[Conditions d'utilisation, finalité & avertissements](#)
- ☐ Je consens expressément au traitement de mes données de santé.
[Informations sur la protection des données](#)
- ☐ Pour contribuer à l'amélioration continue de cette application, j'accepte que Preventicus envoie des rapports de bugs et des données sur l'utilisation de l'application.

Continuer

6.3 Saisir le code d'accès

À l'étape suivante, vous avez la possibilité de saisir un code d'accès (1) afin de débloquer les fonctionnalités avancées de l'application Preventicus Heartbeats. Vous pouvez obtenir un code d'accès, par exemple, dans le cadre d'un programme de prévention proposé par votre caisse d'assurance maladie. Après avoir saisi le code d'accès, cliquez sur le bouton « Continuer avec le code d'accès » pour poursuivre.

Vous avez également la possibilité de vérifier, à l'aide d'un générateur de code, si vous pouvez également obtenir un tel code d'accès. Pour cela, sélectionnez « Continuer sans code d'accès » (2). Sur la page suivante, vous pouvez alors lancer la vérification (3) ou ignorer cette étape (4).

16:00

< Retour

Code d'accès

Avez-vous reçu un code d'accès ? Si oui, veuillez le saisir ici.

Code d'accès

Entrez le code ici

Continuer avec le code d'accès

Continuer sans code d'accès

16:00

< Retour

Sauter

Votre assurance maladie prend-elle en charge les frais ?

Certaines caisses d'assurance maladie et certains partenaires de santé mettent gratuitement à la disposition de leurs affiliés l'application Preventicus Heartbeats dans le cadre d'un programme de prévention des attaques cérébrales

Vérifier maintenant

6.4 S'inscrire et créer un compte utilisateur

Si vous utilisez l'application Preventicus Heartbeats en tant qu'utilisateur, vos données d'utilisateur seront liées à votre compte à l'avenir. Lorsque vous changez de smartphone, il vous suffit de vous connecter à l'application pour que votre licence et vos données soient automatiquement restaurées.

Pour vous enregistrer, veuillez saisir votre adresse e-mail et un mot de passe de votre choix. L'enregistrement ne peut se faire que si toutes les informations sont correctement remplies.

Cliquez ensuite sur "S'enregistrer maintenant" pour lier votre compte d'utilisateur à vos données.

Pour compléter la création de votre compte d'utilisateur et pouvoir accéder à vos données et résultats à tout moment, vous devez confirmer votre inscription à la fin. À cette fin, vous recevrez un e-mail de notre part contenant un lien d'activation. En cliquant sur ce lien, vous confirmez votre inscription.

Note : Vous disposez d'un mois pour confirmer votre adresse e-mail. Si ce délai expire, vous avez la possibilité de demander à nouveau la confirmation et un nouvel e-mail vous sera envoyé.

Note : Si vous ne recevez pas de lien d'activation de confirmation, veuillez contacter notre service clientèle : support@preventicus.com.

7 Écran initial

Vous trouverez sur l'écran initial les principales fonctionnalités de l'application Preventicus Heartbeats :

- **Variante de mesure** (voir Chapitre 8.1 Sélection de la variante de mesure) (1)
- **Rapports** (voir Chapitre 11 Rapports et Telecare) (2)
- **Rappel** (voir Chapitre 12.2 Fonction de rappel) (3)
- **Boîte postale** (voir chapitre 16 Boîte postale) (4)
- **Connexion** (voir Chapitre 12.3.1 Compte d'utilisateur) (5)
- **Zone d'aide/FAQ** (voir chapitre 8 Effectuer une mesure) (6)
- **Choses à savoir** (voir chapitre 12.5 Choses à savoir) (7)
- **Santé** (voir chapitre 15 Santé) (8)

Le menu (9) vous permet d'obtenir des informations sur le profil de l'utilisateur, les paramètres et des informations à propos de la « version complète ».

Vous trouverez plus de détails au Chapitre 12 Menu.



8 Prise de mesure

① **Conseil** : il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet stable pour effectuer une mesure et l'analyse ultérieure du rythme cardiaque avec affichage des résultats. Veuillez vous assurer que la connexion Internet est stable avant de commencer la mesure.

8.1 Sélection de la variante de mesure

Une fois que vous avez saisi vos données, vous accédez à l'interface utilisateur générale. Pour lancer une mesure, cliquez sur le bouton central intitulé "Mesure" dans la barre de navigation.

Dans la version complète, vous avez le choix entre deux options de mesure :

- 1min:** test d'une minute comprenant une analyse complète et un rapport de mesure. La norme pour des mesures régulières.
- 5min:** test détaillé de cinq minutes avec un rapport de mesure et une précision maximale. Recommandé en cas d'anomalies dans le test standard, sur recommandation médicale et surtout si vous souhaitez bénéficier d'une évaluation par le service Telecare en tant qu'utilisateur privé.

Vous pouvez choisir entre les deux variantes sur l'écran de mesure, puis lancer la mesure.

La version gratuite offre une évaluation du rythme à partir d'une mesure de 1 minute : aucune anomalie (le feu est vert) ou anomalie (le feu passe à l'orange). Le résultat vous sera indiqué grâce à un système de feux de signalisation. Seule la version complète permet la création d'un rapport de mesure.




LA MESURE COMMENCE
dès que vous placez votre
doigt sur l'appareil photo

8.2 Préparation de l'appareil

Avant la première mesure, vous recevrez des conseils pour effectuer une mesure (tutoriel). Veuillez les lire attentivement. Une fois le tutoriel terminé, vous pouvez le consulter de nouveau ou commencer une mesure.

Veuillez retirer le chargeur et, le cas échéant, la housse de protection de votre smartphone avant la mesure.

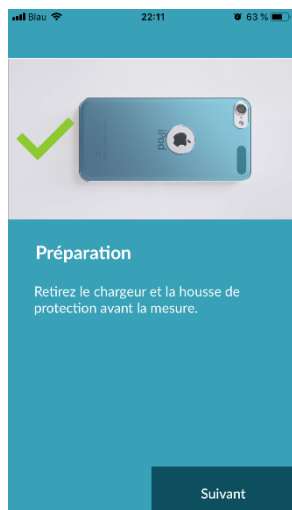

8.3 Position de mesure correcte

Pour que la position de mesure soit correcte, placez le bras et le coude sur une table afin d'être assis le plus confortablement possible. Prenez ensuite votre téléphone et placez la lentille de la caméra sur la partie la plus avancée de votre petit doigt. Assurez-vous que la LED du flash n'est pas masquée. Si vous avez procédé correctement, l'ensemble de l'objectif de la caméra repose sur le doigt.




8.4 Position de mesure alternative

Vous pouvez aussi tenir le smartphone dans votre main. Assurez-vous de tenir votre smartphone de façon bien stable. Placez l'intérieur de votre index sur la lentille de l'appareil photo. Assurez-vous de ne pas couvrir la LED du flash.



8.5 Utiliser l'aide au positionnement

Le positionnement correct de l'objectif de la caméra joue un rôle décisif dans la réalisation d'une mesure correcte. C'est pourquoi la fenêtre de prévisualisation fournie sert d'aide au positionnement. Cette fenêtre de prévisualisation vous permet également d'identifier la bonne caméra sur un smartphone qui en possède plusieurs. L'objectif de la caméra est correctement positionné lorsque le cercle intérieur de la fenêtre de prévisualisation apparaît entièrement en rouge.

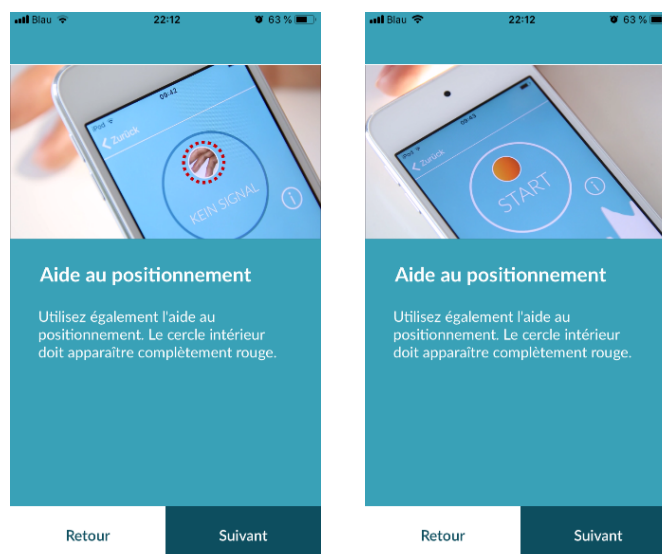

8.6 Reconnaître une bonne qualité de signal

Dans l'étape suivante, le système vérifie la qualité du signal. Placez la caméra sur le bout de votre doigt et attendez que le système calibre la qualité du signal. La mesure démarre alors automatiquement.




8.7 Comportement pendant la mesure

Vous devez adopter une position assise détendue pendant la mesure. Évitez de bouger et de parler durant le contrôle.

8.8 Commencer la mesure

Après avoir appuyé sur « Commencer maintenant la mesure », votre appareil est prêt pour la mesure. Placez la lentille de l'appareil photo au niveau du bout du doigt comme décrit dans le manuel. La mesure commencera automatiquement dès que la force du signal sera suffisante.

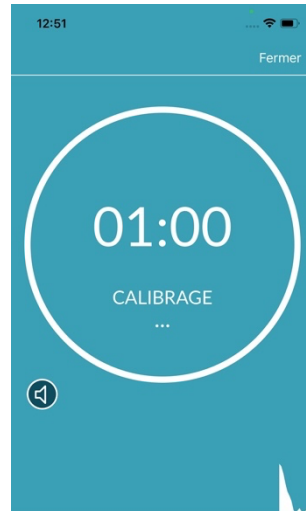

LA MESURE COMMENCE
dès que vous placez votre
doigt sur l'appareil photo

9 Création d'un rapport de mesure

Une fois la mesure terminée, vous avez la possibilité de saisir un titre et de modifier l'année de naissance ou le sexe, si nécessaire. Vous pouvez également préciser comment vous vous sentez (en sélectionnant un état dans une liste) ou créer votre propre commentaire sur la mesure (« Aujourd'hui, je vais très bien » ou « Aujourd'hui, je ne suis pas en forme »). Ces informations sont alors enregistrées dans un rapport de mesure. Vous pouvez ensuite sauvegarder votre rapport de mesure.

10 Interprétation des résultats

Une fois la mesure enregistrée, le résultat s'affiche sur la page de détail correspondante. Celle-ci est divisée en plusieurs sections.

Dans la première section (1), vous trouverez un résumé écrit accompagné de recommandations d'actions possibles.

On y trouve deux vignettes.
La vignette de gauche (2) affiche les résultats concernant votre rythme cardiaque.
Les couleurs possibles sont :

Couleur du feu	Signification
Vert	Rythme cardiaque régulier
Jaune	Arythmie légère (> 5 % de tous les battements sont irréguliers)
Rouge	Arythmie absolue avec suspicion de fibrillation auriculaire En l'absence de contrôle médical et en cas de récurrence, un examen cardiologique immédiat est nécessaire.

Tab. 10.1 Code couleurs et évaluation du rythme cardiaques




La vignette de droite (3) affiche le résultat concernant votre pouls. Les couleurs possibles sont les suivantes :

Couleur du feu	Signification
Vert	fréquence cardiaque normale
Jaune	fréquence cardiaque légèrement augmentée ou diminuée
Rouge	augmentation ou diminution significative de la fréquence cardiaque (tachycardie / bradycardie).

Tab. 10.2 Code couleurs et évaluation de la fréquence cardiaques

Les deux vignettes (2) et (3) fournissent des informations supplémentaires dès qu'on clique dessus :

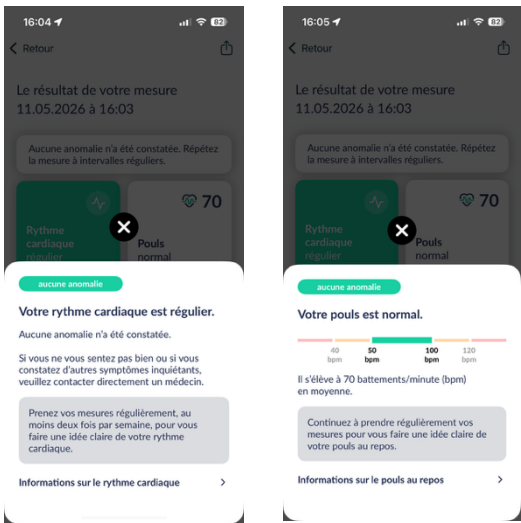

10.1 Mauvaise qualité du signal

Si la qualité de signal est médiocre parce que vous avez bougé, parlé, toussé ou mal positionné la caméra (par ex. au bout du doigt) lors de la mesure, aucune évaluation ne pourra être faite. Dans « Voir le tutoriel de mesurer », vous pouvez visionner à nouveau le tutoriel, avant de répéter la mesure.

Une évaluation fiable du rythme cardiaque avec l'appli dépend de la bonne qualité du signal. Veuillez respecter les points suivants lorsque vous effectuez une mesure:

1. Asseyez-vous bien droit et détendu.
Variante de mesure 1 : Placez l'objectif de la caméra sur la partie la plus avancée de votre doigt afin qu'il soit stable. **Variante de mesure 2 :** Tenez le smartphone de manière stable et calme dans votre main. Placez le bout de votre index sur l'objectif de la caméra.
2. Ne touchez pas la lampe avec votre doigt !
3. Le cercle (aperçu) doit être rouge et entièrement rempli par votre doigt.
4. La qualité du signal est alors calibrée par le système et après 3 secondes, la mesure démarre automatiquement.
5. Si nécessaire, massez le bout du doigt utilisé pour la mesure afin d'augmenter la circulation sanguine.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter le service d'assistance de Preventicus à l'adresse suivante : support@preventicus.com



11 Rapports et Telecare

11.1 Aperçu du rapport de mesure

Pour les premières mesures gratuites ainsi que pour les abonnements en cours, une fois la mesure terminée (1 min ou 5 min), vous recevrez également le résultat sous la forme d'un rapport récapitulatif au format PDF. Vous pouvez y accéder depuis la page détaillée de la mesure, dans la section « Rapport », en appuyant sur la vignette (1).

Celui-ci contient la courbe de fréquence cardiaque enregistrée, la fréquence cardiaque (en bpm) au fil du temps et des informations détaillées sur le rythme cardiaque. Le rapport de résultats de mesure se compose de trois sections (Voir Fig. 11.1).



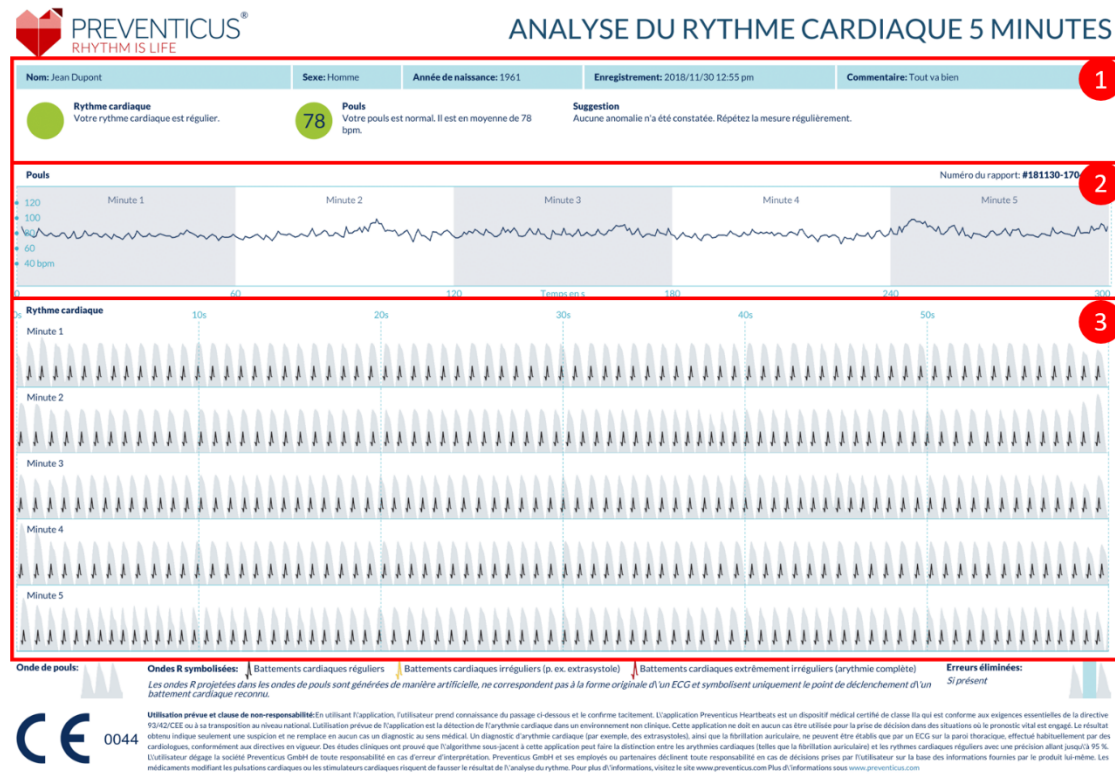


Fig. 11.1 Rapport de mesure Preventicus Heartbeats constitué de trois parties : 1- Résumé des résultats de l'analyse du rythme cardiaque, 2 - Battements par minute (BPM) sur l'ensemble de la mesure, 3- Courbe de pouls d'origine sur l'ensemble de la mesure

Le résumé des résultats de l'analyse du rythme cardiaque (voir Fig. 11.1 / zone 1) contient les données de base ainsi que des informations facultatives, comme le nom et le commentaire relatif à la mesure. En outre, les résultats du pouls et du rythme cardiaque sont fournis sous forme de texte, accompagné d'un code couleurs. Ce dernier correspond à la couleur du feu de signalisation dans l'écran des résultats de l'application (voir chapitre 10). En fonction du résultat, une évaluation médicale supplémentaire vous sera proposée par du personnel qualifié.

La deuxième partie du rapport (voir Fig. 11.1 / zone 2) indique le pouls en battements par minute (bpm) sur l'ensemble de la mesure. Les fluctuations légères et régulières du pouls, comme indiqué dans la Fig. 11.1 / zone 2, sont normales et sont principalement dues à l'interaction entre la respiration et le rythme cardiaque.

Les fluctuations positives ou négatives soudaines, comme dans la Fig. 11.2 sont dues, en revanche, à des arythmies cardiaques et peuvent indiquer des extrasystoles.

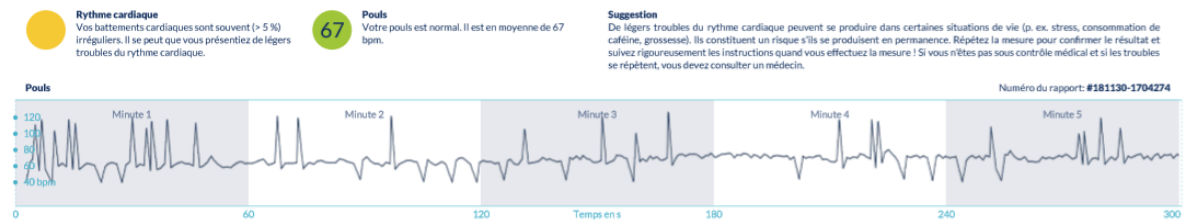


Fig. 11.2 Résultat récapitulatif de l'analyse du rythme cardiaque et du pouls en battements par minute (BPM) sur l'ensemble de la mesure, provenant d'un rapport caractérisé par une arythmie cardiaque légère

Les fluctuations positives résultent de battements cardiaques irréguliers, dont l'intervalle de temps est considérablement réduit comparé au rythme cardiaque précédent par rapport à la moyenne. Les fluctuations négatives de la fréquence cardiaque indiquent, en revanche, un intervalle temporel nettement plus long entre le rythme cardiaque irrégulier et le rythme cardiaque normal précédent par rapport à la moyenne.

La Fig. 11.3 présente un pouls caractéristique d'une fibrillation auriculaire. Le pouls est très irrégulier et les fluctuations se produisent de manière chaotique sur l'ensemble de la mesure.



Fig. 11.3 Résultat récapitulatif de l'analyse du rythme cardiaque et du pouls en battements par minute (BPM) sur l'ensemble de la mesure, provenant d'un rapport caractérisé par une arythmie absolue

La troisième partie du rapport de mesure indique la courbe de fréquence originale. Une ondulation de cette courbe correspond à un battement cardiaque. Pour l'analyse du rythme cardiaque, la courbe de pouls détecte des points équivalents à l'onde R de l'ECG. Ces points sont dessinés sous forme d'ondes R dans la courbe de pouls d'origine afin de détecter / identifier un rythme (voir Fig.4). Les ondes R noires symbolisent un rythme cardiaque régulier, les jaunes un rythme cardiaque irrégulier (par ex. des extrasystoles) et les ondes R rouges un rythme cardiaque très irrégulier en raison d'une arythmie absolue (suspicion de fibrillation auriculaire).

-  Battements cardiaques réguliers
-  Battements cardiaques irréguliers (p. ex. extrasystole)
-  Battements cardiaques extrêmement irréguliers (arythmie complète)

Fig. 11.4. Légende des ondes R dans la courbe de pouls d'origine

Les barres bleues dans la courbe de pouls (voir Fig. 12.5) indiquent une perturbation détectée, pouvant être due à une défaillance causée par le mouvement, la luminosité ambiante et le suivi de la caméra.



Fig. 11.5. Courbe de fréquence cardiaque originale du rapport de mesure avec une anomalie détectée (barre bleue)

11.2 Liste des rapports de mesure


Après chaque mesure, les rapports de résultats sont enregistrés dans une liste et peuvent être consultés dans la rubrique « Résultats ».

Pour mieux comprendre comment lire ce type de rapport, vous trouverez un tutoriel vidéo dans le sous-menu (menu à trois points) (1).

La liste présente les résultats des mesures ainsi que leurs informations essentielles les uns en dessous des autres: résultat du pouls, couleur du feu tricolore correspondant à la mesure et heure à laquelle celle-ci a été effectuée (2).

En appuyant sur un résultat de mesure, celui-ci s'affiche en détail.


Les résultats de mesure peuvent être supprimés à tout moment dans la liste (3). Pour ce faire, cliquez sur l'icône de la corbeille. Vous pouvez alors sélectionner les résultats à supprimer en cochant les éléments correspondants dans la liste. Dans ce mode, vous pouvez à tout moment annuler la sélection d'un résultat de mesure en décochant la case située devant celui-ci. Pour annuler toute la sélection, sélectionnez le bouton « Annuler ». Pour supprimer les résultats de mesure, appuyez sur « Supprimer ». Les résultats de mesure sont immédiatement supprimés.

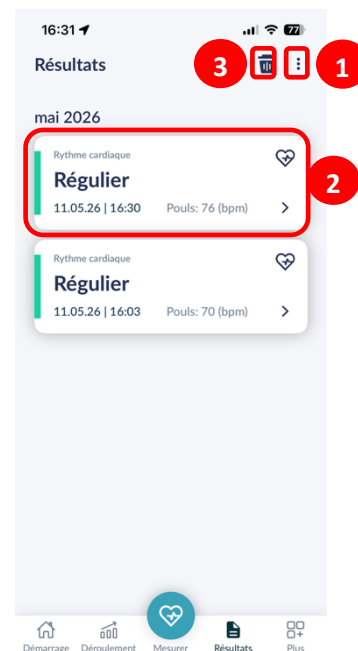

Vous pouvez accéder à nouveau à la page détaillée de chaque résultat de mesure, qui s'affiche automatiquement après chaque mesure, en appuyant sur une entrée de la liste des résultats de mesure (2).

Dans la vue détaillée d'un résultat de mesure, il est possible de partager un rapport au format PDF avec d'autres personnes (4). Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Partager » (iOS :  // Android : ). Vous pouvez ensuite choisir parmi une sélection de services pour envoyer le rapport ou l'enregistrer sur votre smartphone en dehors de l'application. Veuillez noter qu'il est recommandé de crypter le document ou de le protéger par un mot de passe lors de l'envoi des rapports.

Même si vous avez ouvert un rapport PDF directement en appuyant sur la vignette correspondante (5), le bouton « Partager » situé dans le coin supérieur droit reste disponible.

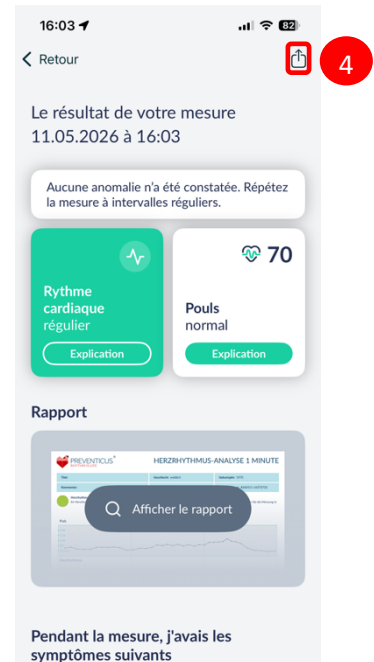

11.3 Telecare - Liste de rapports

Si vous disposez d'un ou de plusieurs rapports avec suspicion d'arythmie légère (feu jaune) ou d'arythmie absolue (feu rouge), il est possible d'envoyer ces rapports au service Telecare en vue d'une évaluation payante.

Si vos mesures du rythme cardiaque présentent des anomalies, des techniciens médicaux expérimentés d'un centre de télésanté spécialisé procèdent à un contrôle qualité de vos données. Vous et votre médecin pouvez ainsi vous assurer qu'un diagnostic présumé repose sur une mesure exploitable et exempte d'interférences et qu'il est fiable, ou bien que des signaux parasites ou des erreurs de mesure pourraient en être la cause.


Si vous avez déclenché le service de télésanté pour une ou plusieurs mesures, le résultat vous sera renvoyé dans l'application dans un délai de 3 jours ouvrables. Vous découvrirez comment cela fonctionne dans le chapitre suivant.



11.4 Telecare - Commander un rapport


Toute mesure présentant un rythme cardiaque anormal (feu orange ou rouge) peut être envoyée au service Telecare. Pour ce faire, ouvrez la page de détail d'une mesure. Vous verrez alors, sous le rapport PDF, la vignette du service Telecare (1). En appuyant sur cette vignette, vous lancez le processus d'envoi. La première étape vous indique (2) si le service Telecare est disponible gratuitement pour vous (par exemple, une fois par mois avec l'abonnement Value) ou si vous souhaitez acheter une analyse unique (par exemple, pendant la période d'essai gratuite ou avec l'abonnement Classic).

Si vous utilisez le service Telecare pour la première fois, vous devez accepter une seule fois les conditions générales et la politique de confidentialité du service Telecare (3) (4).

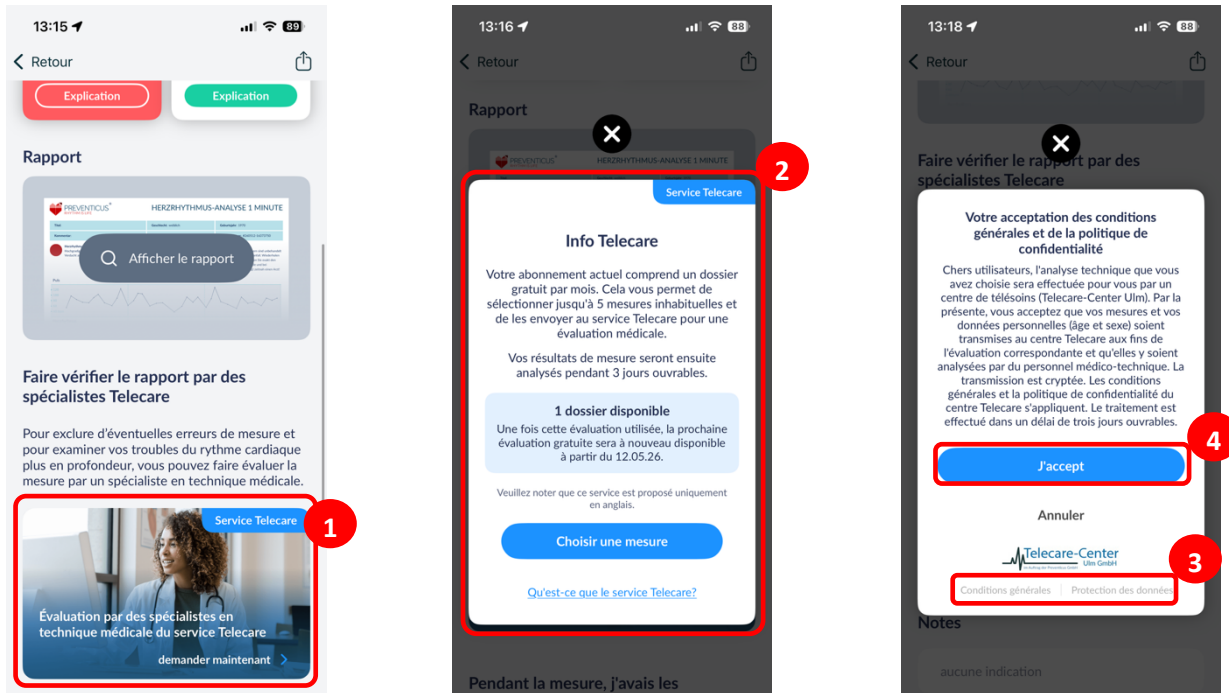


À la dernière étape, sélectionnez dans la liste des résultats qui s'affiche la ou les mesures que vous souhaitez faire analyser. Au départ, la mesure à partir de laquelle vous avez lancé le processus est sélectionnée. Avec l'abonnement Value, vous avez la possibilité, une fois par mois, d'envoyer jusqu'à 5 mesures simultanément pour une analyse. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner plusieurs mesures dans la liste en appuyant sur le cercle situé devant chaque mesure (une coche apparaît) (5). Une fois votre sélection terminée, appuyez sur « Analyser » (6). Le processus d'envoi est alors terminé.

Remarque: Si vous avez acheté une analyse individuelle, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule mesure.

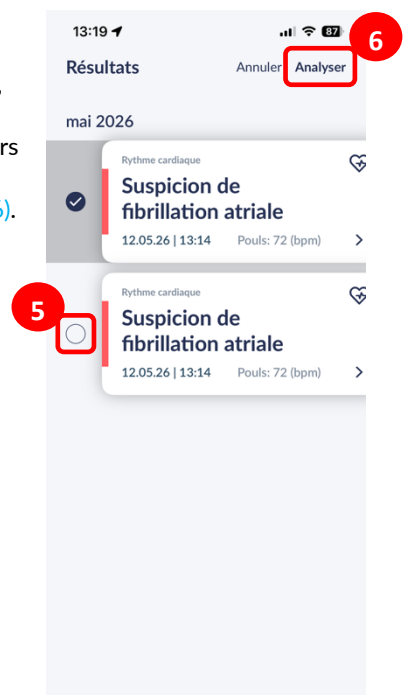


Il vous sera ensuite indiqué dans la liste des résultats de mesure et sur la page détaillée des mesures envoyées (7) que la ou les mesures sont actuellement en cours d'analyse. Vous recevrez le résultat dans un délai de 3 jours ouvrables.

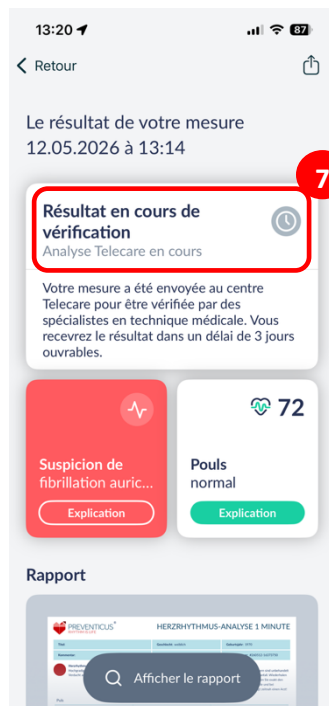

11.5 Telecare – Afficher l'état et le rapport

Dès que l'évaluation Telecare est terminée, vous recevez cette information directement sur la page d'aperçu de l'application (1). Vous êtes également informé du nouveau statut dans la liste des résultats de mesure et sur la page de détail des mesures envoyées (2). Sur la page de détail de la mesure, le rapport PDF d'origine a été remplacé, dans la section « Rapport », par le nouveau rapport Telecare, plus complet. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur la vignette correspondante (3).

Vous pouvez également partager le rapport Telecare avec d'autres personnes depuis la vue détaillée. En appuyant sur le bouton « Partager » (iOS :  // Android : ) (4), vous aurez alors le choix entre plusieurs options pour envoyer le rapport ou l'enregistrer sur votre smartphone en dehors de l'application.

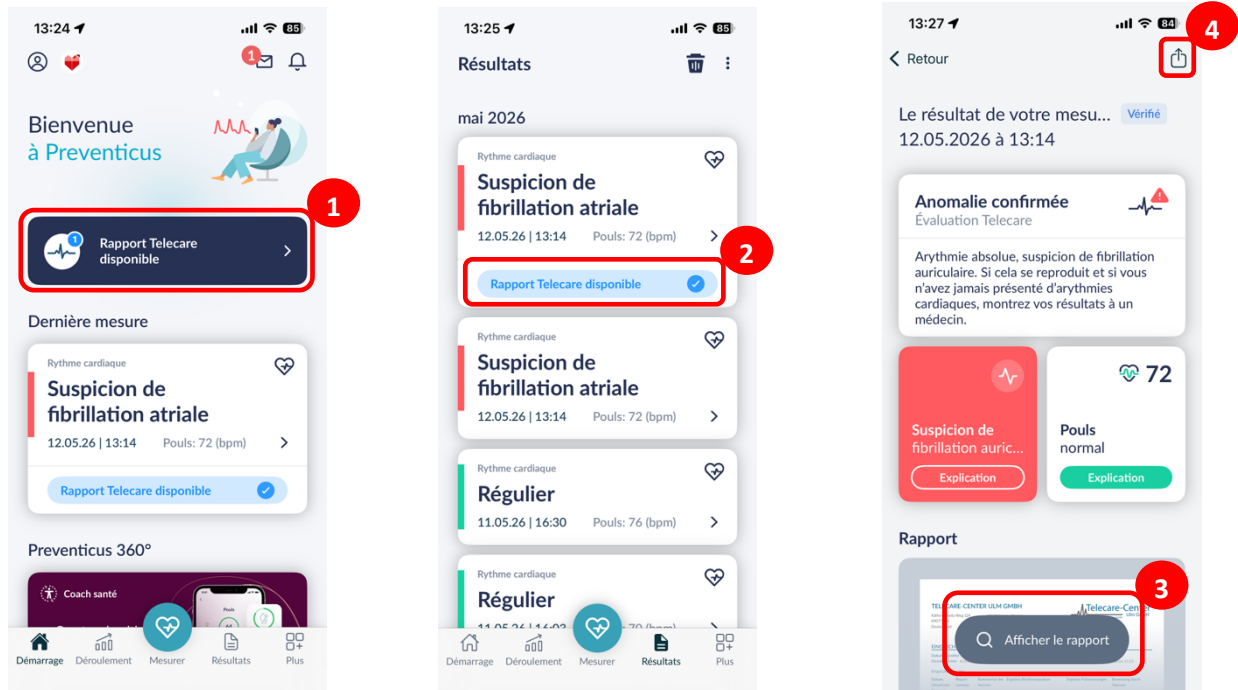

11.6 Accueil - Dernière mesure

Si vous disposez de la version complète et que vous avez effectué une mesure, le résultat de votre dernière mesure sera affiché sur la page d'accueil. En cliquant sur l'affichage, vous accéderez au rapport détaillé des résultats de votre dernière mesure.




12 Menu

Vous pouvez accéder au menu à tout moment en cliquant sur « Plus » dans la barre de navigation.

Il se compose de :

- [Compte utilisateur](#) : connexion et enregistrement (voir *Chapitre 12.3.1 Compte d'utilisateur et Chapitre 14 Supprimer le compte utilisateur*)
- [Données de base](#) : informations personnelles (voir *Chapitre 12.1 Données de base*)
- [Achat In-App](#) : aperçu des différentes fonctions de la version d'évaluation et version complète (voir *Chapitre 13.1 Options d'achat*)
- [Rappel](#) : fonction de rappel des mesures régulières (voir *Chapitre 12.2 Fonction de rappel*)
- [Juridique](#) : informations à propos de l'utilisation prévue, des conditions d'utilisation, de la protection des données, etc.
- [Section d'aide](#) : FAQ sur les questions fréquemment posées, ainsi que des conseils et des informations sur le thème de la mesure.
- [À propos de Heartbeats](#) : informations à propos de l'application Preventicus Heartbeats (voir *Chapitre 12.4 À propos de Heartbeats*)
- [Numéro de version](#)

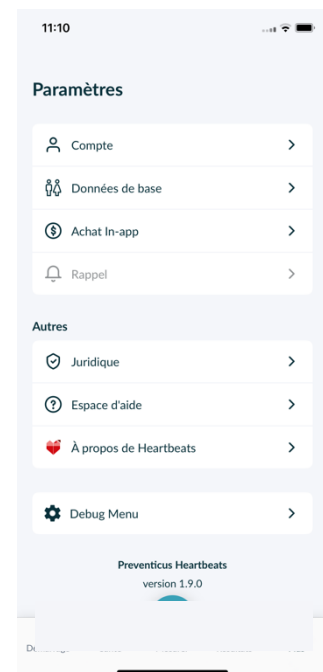

12.1 Données de base

Les données de base se composent du sexe et de l'année de naissance. Après la première mesure effectuée, vous devez fournir vos données de base lors de la création du rapport de mesure afin qu'il puisse être utilisé pour l'analyse.

En tant que participant au programme de dépistage, vous saisissez ces données lors de votre inscription.

Dans l'option de menu Données de base, vous pouvez consulter les informations à tout moment et les modifier ultérieurement.



12.2 Fonction de rappel


Dans le menu « Rappel », vous avez la possibilité de vous rappeler de prendre vos mesures quotidiennes. Vous allez ainsi recevoir sur votre smartphone des notifications push vous rappelant de prendre vos mesures.

(i) Conseil : pour utiliser la fonction de rappel, vous devez être enregistré. Vous avez la possibilité de créer vos propres rappels. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « + » (1).

Un nouveau rappel s'affiche (2). Saisissez un nom, par exemple « Mesure quotidienne tôt », puis sélectionnez une heure et les jours de la semaine. Confirmez le rappel pour le créer (3) en appuyant sur l'icône « Ok » (✓).

Vous pouvez modifier le rappel (5) et le supprimer (4) à tout moment. Pour supprimer l'entrée, allez à l'icône « Modifier » (5), puis sélectionnez l'icône . Le rappel sera définitivement supprimé.


Vous pouvez également désactiver un rappel (6) en appuyant sur l'icône . Si un nouveau rappel est créé, ce bouton est activé par défaut.

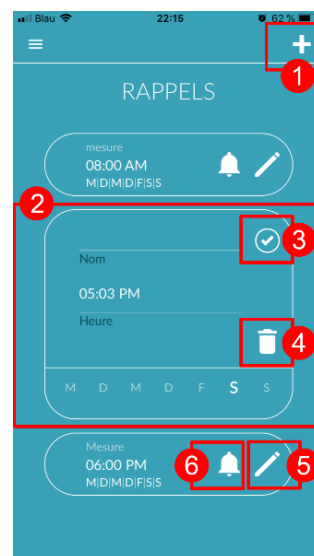

12.3 Connexion

Si vous vous êtes enregistré et disposez donc d'un compte utilisateur, vous pouvez vous connecter à tout moment à l'aide de votre adresse électronique ou de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe et accéder à vos mesures, rapports et services activés.

1. Pour vous connecter, sélectionnez le bouton "Log in" sur l'écran de démarrage.
2. Vous accédez alors à l'écran de connexion, où vous pouvez saisir votre adresse électronique, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur le bouton "Log in" pour terminer la procédure. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser à tout moment et en choisir un nouveau en cliquant sur "Mot de passe oublié ?".
3. Après avoir réussi à vous connecter, vous accédez à la page de présentation de toutes les fonctions.

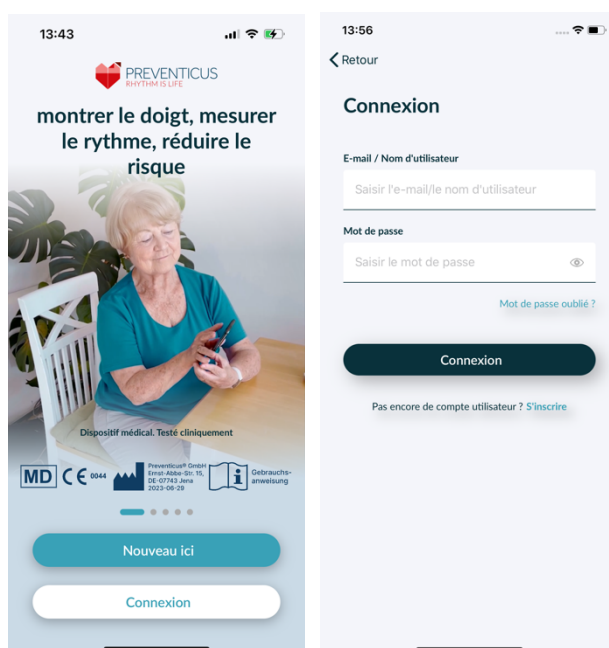

(i) Remarque : Si vous avez fait une erreur en introduisant votre mot de passe ou si vous avez introduit un mot de passe incorrect, le système vous en informera. Dans ce cas, veuillez saisir à nouveau votre mot de passe.

(i) Remarque : Si vous ne pouvez pas réinitialiser votre mot de passe, il est très probable que vous ne soyez pas encore enregistré en tant qu'utilisateur. Dans ce cas, cliquez sur le lien "Pas encore de compte utilisateur ? S'inscrire" et inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur.

12.3.1 Compte d'utilisateur

La rubrique « Compte d'utilisateur » se trouve dans la barre de navigation sous « Plus » et affiche toutes les données associées à votre compte utilisateur. Vous pouvez y voir si vous êtes connecté à votre compte utilisateur et, le cas échéant, avec quelle adresse e-mail (1).

Vous trouverez également ici des informations sur votre abonnement et les services inclus. Vous avez ici la possibilité de modifier, de renouveler ou de résilier votre abonnement (2).

Vous verrez également s'afficher tous les services associés à votre compte utilisateur qui sont actifs pour vous (3).

Si vous avez reçu un code d'accès, par exemple par courrier de votre caisse d'assurance maladie, vous pouvez également le saisir dans votre compte utilisateur (4) afin de débloquent les prestations supplémentaires.

(i) Remarque : les informations ne s'affichent que si vous vous êtes connecté avec vos données d'accès - e-mail ou nom d'utilisateur et mot de passe. En outre, un compte d'utilisateur n'existe que si vous vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur.



12.3.2 Changement d'appareil

Remarque : le transfert du compte, y compris de toute licence d'utilisateur existante et de tous les rapports, n'est possible que si vous changez de smartphone et que vous vous êtes déjà enregistré.

Les étapes suivantes vous permettent de transférer votre compte d'utilisateur Preventicus, y compris toutes les données, sur votre nouveau smartphone :

1. Installez l'application Preventicus Heartbeats sur votre nouveau smartphone.
2. Ouvrez l'application Preventicus Heartbeats.
3. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le bouton "Sign In" pour vous connecter à votre nouvel appareil.
4. Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe que vous avez utilisés pour vous inscrire à Preventicus.
5. Cliquez ensuite sur "Se connecter".

Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez l'option "Mot de passe oublié". Vous pourrez ainsi réinitialiser votre mot de passe et en choisir un nouveau.

Si vous avez complètement oublié vos données de connexion ou si vous n'êtes pas sûr d'être déjà enregistré, veuillez contacter notre service clientèle : support@preventicus.com.

i Remarque : il n'est pas possible de se connecter sur deux appareils en même temps. Vous serez automatiquement déconnecté sur le deuxième appareil lorsque vous vous connecterez sur un autre appareil.

16:03 Déconnexion

NOUVELLE CONNEXION

E-mail/Nom d'utilisateur

Mot de passe [Mot de passe oublié](#)

Ok

Déconnexion

i Votre session a expiré. Veuillez vous identifier à nouveau.

12.3.3 Utilisateurs multiples - changement d'utilisateur


Vous avez la possibilité de configurer l'application Preventicus Heartbeats pour plusieurs utilisateurs.

Pour ce faire, utilisez l'option de création d'un compte utilisateur pour chaque utilisateur afin de garantir que les données de chaque utilisateur sont privées et personnalisées.

Une fois le nouveau compte créé, vous pouvez à tout moment modifier le compte et donc l'accès.

Situation initiale - Un utilisateur est déjà connecté :

1. Dans la barre de navigation, sélectionnez « Plus », puis cliquez sur « Compte d'utilisateur ».
2. Dans le compte d'utilisateur affiché, vous pouvez voir si un compte est actuellement connecté et lequel.
3. Pour modifier le compte d'utilisateur, sélectionnez l'icône dans le coin supérieur droit (1). Vous avez le choix entre "Se déconnecter" et "Supprimer le compte utilisateur". Veuillez choisir l'option "Déconnexion".
4. Après avoir réussi à vous déconnecter, vous reviendrez à l'écran d'accueil. Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application avec vos propres données d'accès en cliquant sur le bouton "Connexion". Une fois la connexion réussie, vous verrez toutes vos mesures personnelles ainsi que vos services débloqués individuellement.

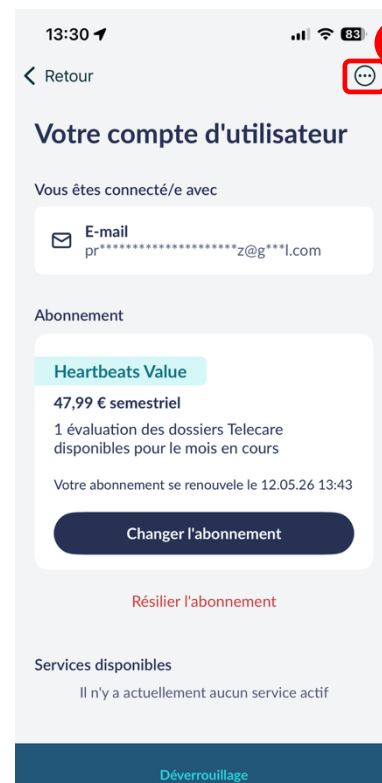

Remarque : les services activés, tels que les licences de version complète ou la participation au programme de soins préventifs d'une compagnie d'assurance maladie, sont liés au compte de l'utilisateur et ne peuvent être transférés ou partagés.

12.4 À propos de Heartbeats

La section « À propos de Heartbeats » donne des informations sur les conséquences de l'arythmie cardiaque, ainsi que sur les fonctionnalités et le contenu de l'application Preventicus Heartbeats.

Vous pouvez y accéder via la barre de navigation, sous « Plus ».



12.5 Choses à savoir

Dans la section "Choses à savoir", vous trouverez des informations sur la fibrillation auriculaire, la santé cardiaque, la prévention des accidents vasculaires cérébraux et le programme de dépistage.

13 Version complète

13.1 Options d'achat

« Achat In-app » est une sous-rubrique du menu situé dans la barre de navigation, sous « Plus ». Cet aperçu présente les abonnements et les formules proposés, ainsi que les prestations et les avantages des différentes options.

En tant que nouvel utilisateur, vous avez la possibilité d'effectuer 7 mesures avec une analyse complète. Vous pourrez ensuite choisir l'abonnement et le forfait qui vous conviennent le mieux : par exemple « Classic » ou « Value ». Les prestations varient d'un forfait à l'autre. Renseignez-vous sur la page des options d'achat pour connaître les différences et les points communs avant de faire votre choix.

Les abonnements sont également proposés avec différentes durées et des avantages tarifaires correspondants.

i Conseil : il s'agit d'achats dans l'application. Pour faire cet achat, il est nécessaire d'avoir un compte de store actif sur votre système d'exploitation.

i Conseil : pour pouvoir faire un achat, vous n'avez pas besoin d'être enregistré.

Les achats validés peuvent être restaurés via le menu « Achats In-App » tant que la période de validité n'est pas écoulée. (2)

i Conseil : nous offrons à nos clients iOS, pour un achat sur l'application, la possibilité de restaurer tous les achats intégrés sur le nouvel appareil même s'ils changent de smartphone, mais avec le même identifiant Apple. Cela a pour but d'éviter de perdre des achats si l'ancien appareil était perdu. Pour lier les informations d'« Achat terminé » à votre compte, nous utilisons iCloud Drive. Autrement dit, iCloud Drive est une condition préalable à un achat dans l'application Preventicus Heartbeats.

i Conseil : si vous n'avez pas accès à la version complète, veuillez vérifier que vous êtes bien connecté à l'application. Si vous n'êtes pas encore enregistré en tant qu'utilisateur de l'application, fermez toutes les applications de votre smartphone. Fermez l'application et redémarrez-la. Ouvrez l'élément « Achats In-App » du menu. En bas, vous trouverez le bouton « Restaurer les achats ». Cela devrait vous donner à nouveau accès à la version complète.

14 Supprimer le compte utilisateur

Si vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur dans l'application Preventicus Heartbeats, vous pouvez supprimer votre compte utilisateur et les informations et documents associés à tout moment.

Veuillez noter que cette action est définitive. Vos données ne peuvent pas être restaurées si vous changez d'avis.

Étape 1 : Que se passe-t-il si vous supprimez votre compte ?

- Toutes les données, tous les rapports et tous les achats associés à ce compte seront perdus.
- Vous n'aurez plus accès aux mesures et rapports antérieurs.
- Vous perdrez l'accès aux achats que vous avez effectués et au contenu que vous avez acheté sur l'AppStore ou Google Play, par exemple les examens de télésoins.


Étape 2 : Vérification et téléchargement des données

Avant de supprimer votre compte :

- Vérifiez les données de votre compte.
- Les rapports que vous souhaitez conserver doivent être soit enregistrés, soit transférés sur un autre PC, soit transmis avant la suppression.
- Pour ce faire, utilisez la fonction "Partager" sur chaque rapport.

Étape 3 : Suppression du compte

1. Ouvrez le menu.
2. Sélectionnez la section "Compte utilisateur" dans le menu.
3. Dans la partie supérieure de la vue de votre compte utilisateur, vous trouverez une icône avec trois points, derrière laquelle se cache un menu de navigation supplémentaire.
4. Cliquez sur l'icône à trois points pour ouvrir le menu de navigation supplémentaire.
5. Sélectionnez ensuite l'option "Supprimer le compte". L'écran suivant énumère toutes les données qui seront supprimées.
6. Pour supprimer définitivement votre compte utilisateur, cliquez sur le bouton "Supprimer le compte" et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
7. Si votre compte a été supprimé avec succès, vous verrez un message d'avertissement.

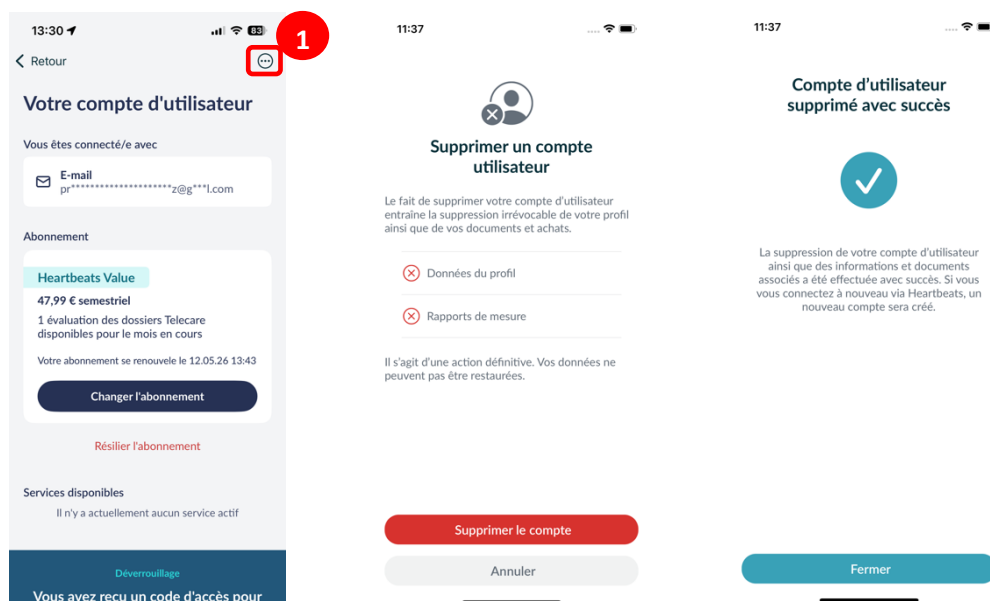


15 Santé

Vous pouvez accéder à la section "Santé" via la barre de navigation. Pour les utilisateurs de la version complète ou les utilisateurs du programme de prévention, la zone présente un graphique du rythme cardiaque et du pouls.

Dans le graphique supérieur, les résultats de l'analyse du rythme cardiaque de vos mesures sont affichés en couleur (vert, jaune, rouge) à l'aide d'un diagramme circulaire. Sous le cercle se trouve une liste indiquant le nombre de fois où vous avez eu une mesure avec un résultat de rythme cardiaque vert - "Régulier", jaune - "Irrégulier" et/ou rouge - "Fibrillation auriculaire suspectée".

Dans le graphique ci-dessous, les valeurs de pouls (battements de cœur par minute) pour chacune de vos mesures sont représentées sous forme de points sur une période d'un mois. L'échelle de couleurs à gauche indique si le pouls est normal (vert), légèrement augmenté ou diminué (jaune) ou fortement augmenté ou diminué (rouge). En outre, le pouls moyen ainsi que les pouls minimum et maximum du mois sélectionné sont affichés.

Les deux graphiques se rapportent chacun à un mois sélectionné. En cliquant sur les flèches situées à côté du mois, vous pouvez passer d'un mois à l'autre et comparer vos valeurs.

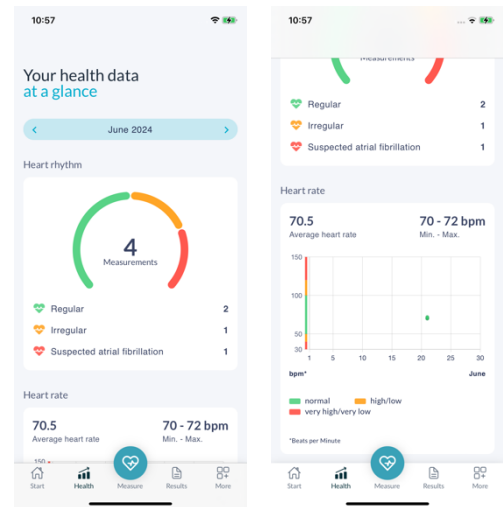


16 Boîte postale

La boîte aux lettres se trouve en haut à droite de l'écran d'accueil. Pour ouvrir la boîte aux lettres, cliquez sur l'icône de la lettre.

Dans la boîte aux lettres, toutes les notifications importantes sont listées par ordre chronologique. Les nouvelles entrées sont signalées par une bulle sur l'icône de la lettre. Dans la boîte aux lettres, vous avez également une indication des nouvelles entrées qui n'ont pas encore été lues.

En cliquant sur une entrée dans la boîte aux lettres, la boîte de dialogue détaillée correspondante s'affiche et de là, vous accédez à l'écran respectif visé par la notification.

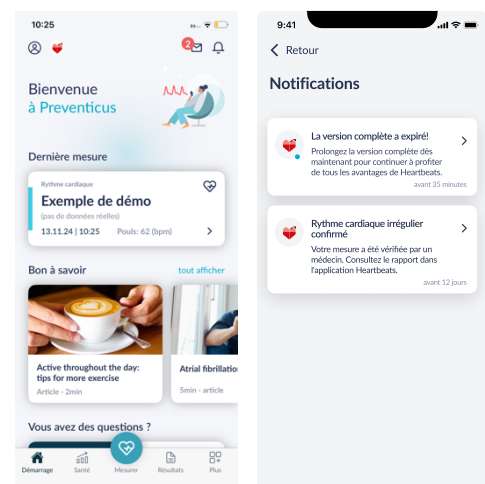

17 Messages d'erreur

Comment accéder à l'application Preventicus Heartbeats ? Comment installer l'application Preventicus Heartbeats sur mon téléphone ?

Voici comment installer Preventicus Heartbeats :

1. Sur votre smartphone Android (par ex. Samsung ou Huawei), ouvrez le Google Play Store ou sur votre smartphone iOS (iPhone), ouvrez l'App Store.
2. Entrez "Preventicus Heartbeats" dans le champ de recherche.
3. Appuyez sur "Télécharger" ou "Installer" et observez la progression.
4. Une fois l'application installée, la description passe de "Installer" à "Ouvrir".
5. Tapez sur "Ouvrir" pour lancer Preventicus Heartbeats. De même, l'application apparaîtra sous la forme d'une icône de cœur sur l'écran d'accueil de votre smartphone. En appuyant sur le logo, ils peuvent également lancer l'application.

Que dois-je faire si la connexion Internet est faible (code d'erreur 500) ?

Essayez de vous placer à proximité de votre routeur WLAN ou activez les données mobiles de votre smartphone pour qu'elles soient utilisées par Heartbeats. Si la connexion est toujours mauvaise, activez et désactivez à nouveau le mode Avion de votre smartphone.

Que dois-je faire si je ne peux pas mettre à jour l'application ?

Veuillez contacter support@preventicus.com.

Que dois-je faire si l'application affiche un fouillis de lettres ou une langue différente ?

Veuillez contacter support@preventicus.com.

Que dois-je faire si l'application affiche le message suivant : « Jeton de session non trouvé » ?

Veuillez contacter support@preventicus.com.

Que dois-je faire si je n'ai pas de connexion avec le serveur ? (Message : « Problèmes de communication avec le serveur »)

Veuillez contacter support@preventicus.com.

Que dois-je faire si l'application ne s'ouvre pas ou se bloque ?

Fermez l'application et ouvrez-la à nouveau. Si l'application ne fonctionne toujours pas, veuillez la désinstaller. Réinstallez-la à partir de l'app store correspondant et connectez-vous à nouveau à l'application avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Si cela ne fonctionne pas non plus, éteignez et rallumez votre smartphone, puis ouvrez à nouveau l'application.

18 Désinstaller l'application

Preventicus Heartbeats est un logiciel autonome pouvant être utilisé avec un smartphone, mais n'est pas un appareil électromédical au sens de la norme CEI 60601-1. Le produit est supprimé en désinstallant l'application du smartphone de l'utilisateur. Si vous supprimez une application pour laquelle vous avez payé, vous pouvez la réinstaller gratuitement.

19 Données techniques

	iOS	Android
Langue	allemand anglais français espagnol italien	allemand anglais français espagnol italien
Système d'exploitation nécessaire	iOS 15	Android 8.0



Preventicus® GmbH
Ernst-Abbe-Str. 15,
DE-07743 Jena

Ce logiciel autonome est un dispositif médical faisant partie de la classe de risque IIa, conformément à la règle 11 du règlement (UE) 2017/745.

20 À propos du fabricant

L'application Preventicus Heartbeats est un produit de Preventicus GmbH, dont voici les coordonnées :

Preventicus GmbH
Ernst-Abbe-Straße 15
DE-07743 Jena
Allemagne
Téléphone : +49 (0)3641 55 98 45 -0
Site Web : www.preventicus.com
Adresse e-mail : info@preventicus.com

Pour en savoir plus sur le produit et son utilisation, veuillez vous adresser à notre Service clients :

Adresse e-mail : support@preventicus.com